

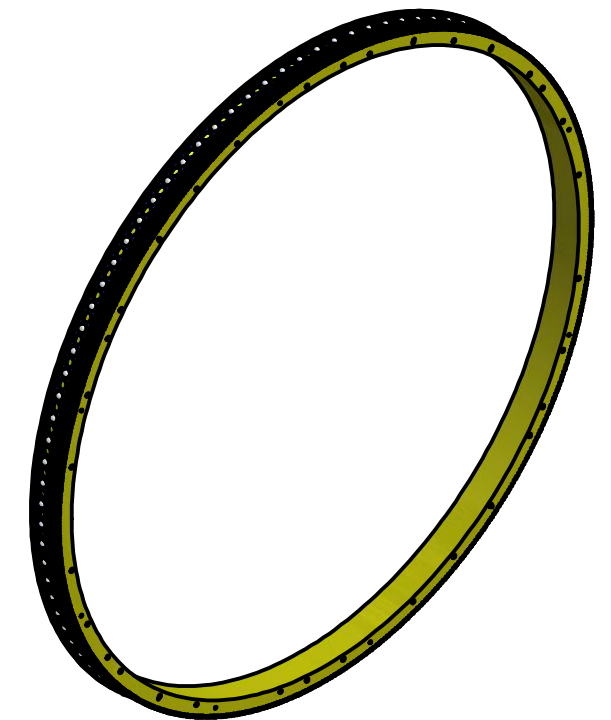
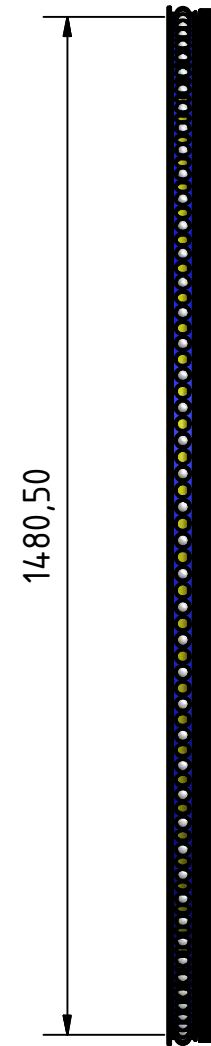
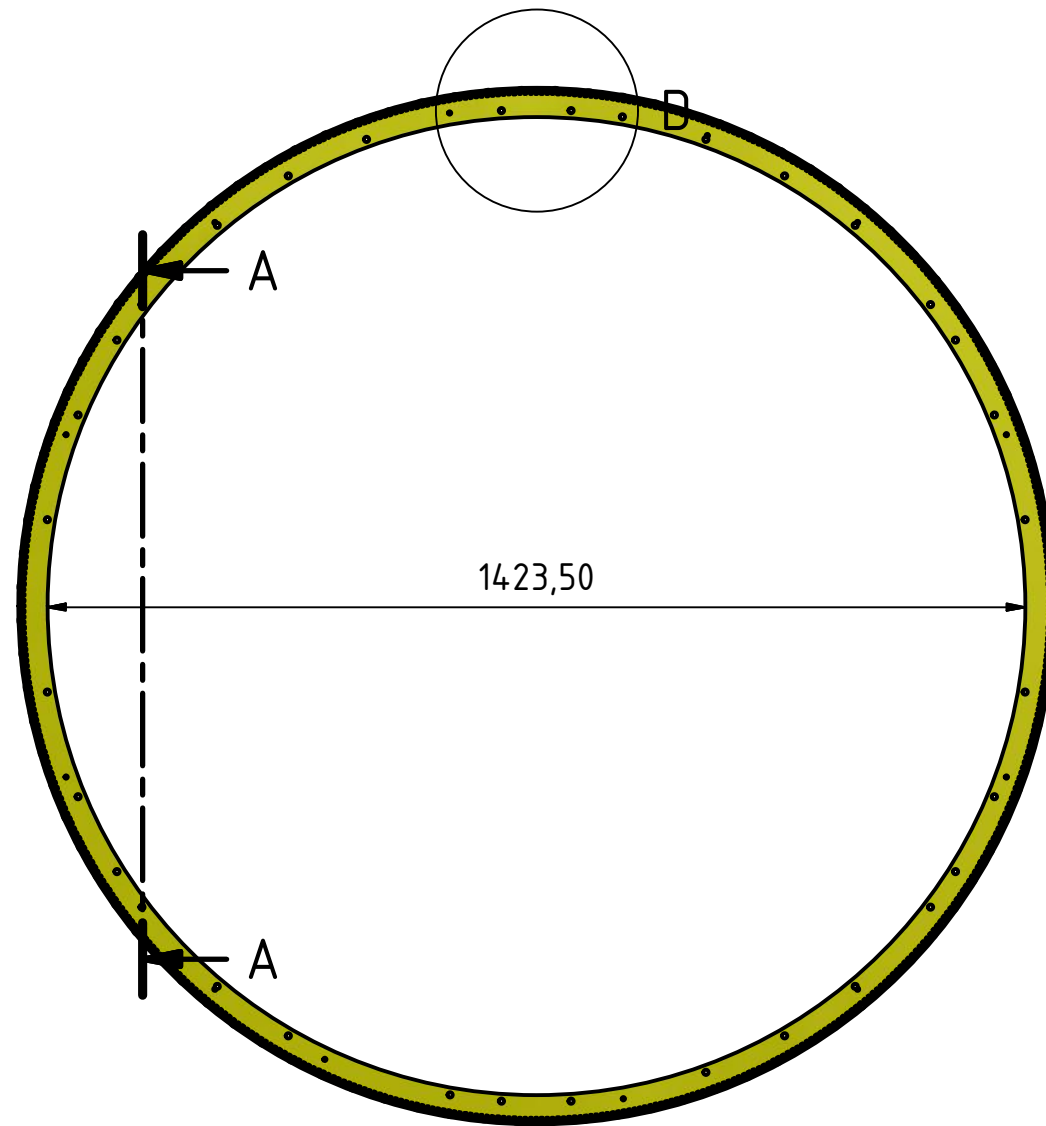



A-A (1 : 11)

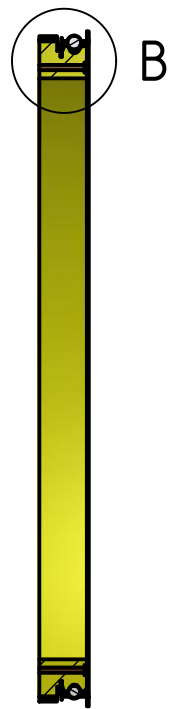

seals

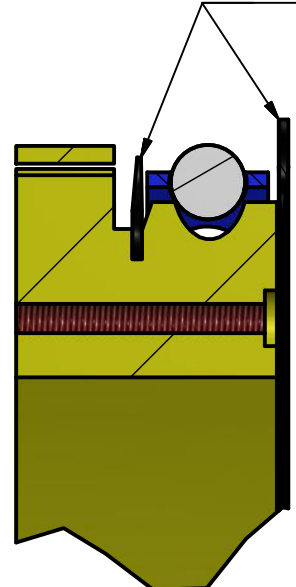

B (1 : 2)

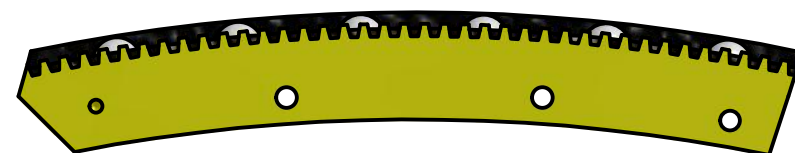

D (1 : 3)

Picker Zng.-Nr.


Sach:-Nr.

Oberflächenbehandlung

- gehärtet HRC / HV:
- lackiert RAL:
- gal. Verzinkt Schichtdicke:
- pulerbeschichtet RAL:
- eloxiert

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

E			
D			
C			
B			
A			
Index	Änderung / changing	Datum	Name



Projektionsebene

	Datum	Name
Konstr.	03.04.2017	W. Bergmann
Zeichner		
geprüft:		

Maßstab: Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-f

Material: Stückzahl:

Inter Medical
Daimlerstr. 34-36
32312 Lübbecke

Insite ring

Zng.-Nr. Blatt sheet 1
DIN A3

Projekt: